


# Hydrogen Inhalation -device- (水素吸入器本体) 一部仕様変更のお知らせ

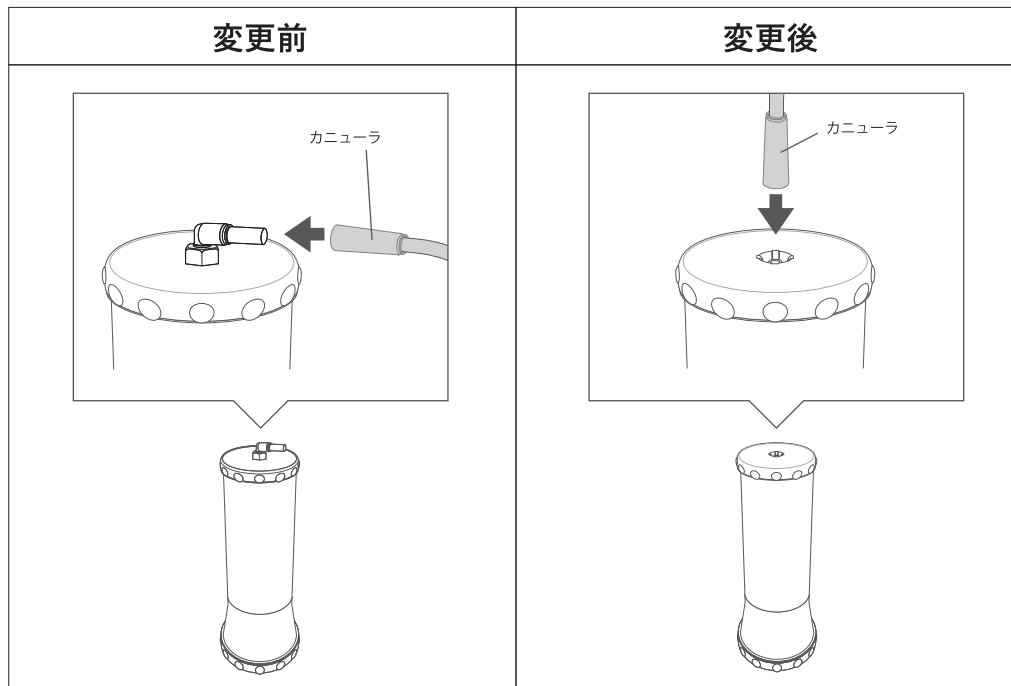

※カニューラは本品に付属していません

変更内容：本体容器フタ、カニューラ等接続部の変更

変更理由：接続部の簡易化

変更時期：現行品在庫がなくなり次第順次

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら当研究会にてご提供しております臨床供給品「Hydrogen Inhalation -device-」(水素吸入器本体)につきまして、上記の通り一部仕様が変更となりますのでご案内申し上げます。

皆様には何かとご不便とご迷惑をお掛け致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

